


KARTA POMIAROWA

na indywidualne zamówienie
ortez dziecięcych

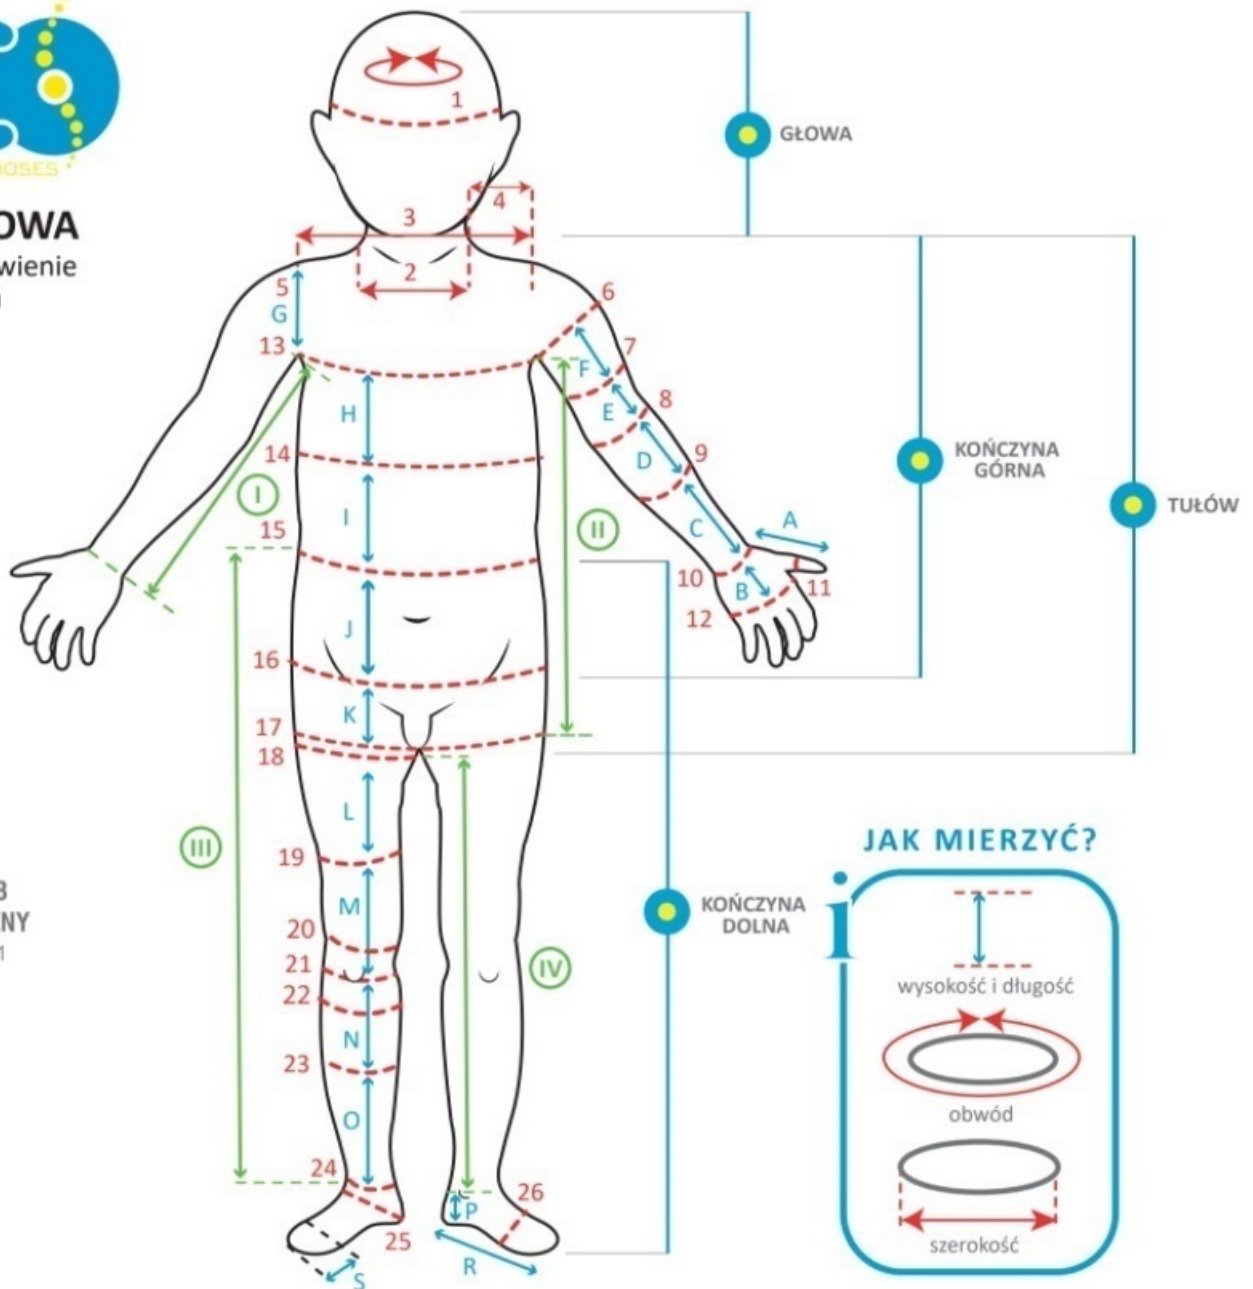

MEDICAL DEVICE CLASS 1
WYRÓB MEDYCZNY KLASA 1

REH4MAT

PCO
POSTURAL COMPRESSION ORTHOSES

POMIAR POSZCZEGÓLNYCH ORTEZ

KOŃCZYNA DOLNA

PCO-L-09	18,19,20,21,22,23,	L, M, N,	IV.
----------	--------------------	----------	-----



! UWAGA!

- Pomiary tułowia i kończyny górnej należy wykonywać na pacjencie w pozycji leżącej.
- Pomiary bioder i kończyn dolnych należy wykonywać na pacjencie w pozycji stojącej.
- Wszystkie pomiary muszą być podane w centymetrach!
- Prawidłowo dobrany rozmiar ortezi jest wówczas, gdy po włożeniu ręki pomiędzy ortezę PCO, a ciało pacjenta, wyczuwalny jest znaczny opór. Wówczas, ze względu na swoją dynamiczną kompresję, orteza powinna rozciągnąć się o max. 5cm.

NR.	POMIAR	Obwód części ciała	Szerokość części ciała	Długość części ciała
				↕ (CM)
18	OBWÓD UDA			L
19	OBWÓD POMIĘDZY 18 i 20			M
20	OBWÓD UDA 5 CM POWYŻEJ ŚRODKA RZEPKI			N
21	OBWÓD KOLANA			POMIAR KONTROLNY
22	OBWÓD ŁYDKI 5 CM PONIŻEJ RZEPKI			IV
23	OBWÓD ŁYDKI			

LEGENDA:  - POMIAR NIEDOSTĘPNY